

**BANDO ESPLORATIVO N. 159 DEL 16.10.2018 --PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA " Pompa a Siringa Orchestra base Primea" SCADENZA IL 30.10.2018-- per Ostetricia- Ginecologia Aziendale -- Fascicolo n° 130 /f ANNO 2018**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato - aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- 1.denominazione dispositivo medico conosciuto : **" Pompa a Siringa Orchestra base Primea" ;**
  - 2.indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico: Mantenimento dell'Anestesia con l'infusione di due farmaci in contemporanea ;
  3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicato : gestire fino ad 8 vie di infusione in tci (due in simultanea) come da scheda allegata;
  - 4 denominazione del produttore Fresenius Kabi e distribuito in Calabria dalla ditta Arga Medicali;
- Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il 30.10.2018 c.a., un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", Via Vinicio Cortese, 10 - 88100 Catanzaro


Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse bando esplorativo n. 159/2018).

Il plico dovrà contenere:


1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, numero ;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitativa e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
5. Costo unitario presunto (desunto da listino) da allegare;
6. **Quantità presunto "2 Pompe a Siringa mod. DPS per infusione di Farmaci endovenosi + una base Primea+.**

Punto Istruttore  
Vitaliano Marino

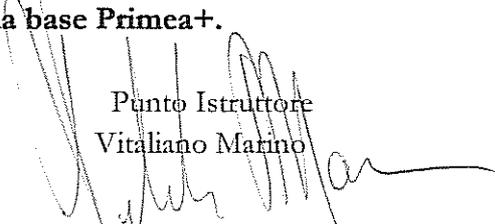

Email [ymarino@aocz.it](mailto:ymarino@aocz.it) tel 0961-883575 fax 0961-883505

Responsabile del Procedimento  
dott. Sergio Chiarèlla

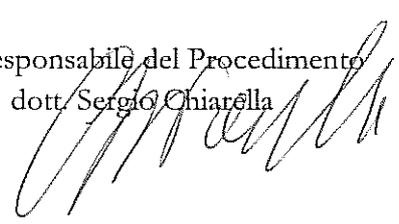

### Sistema per Anestesia Endovenosa mod. ORCHESTRA base Primea

- Deve offrire le principali modalità di anestesia in un'unica soluzione;
- Deve consentire un miglior controllo nelle diverse fasi dell'anestesia, ed aumentare il comfort post-operatorio del paziente.
- Gestire fino ad 8 vie di infusione in TCI (2 in simultanea).
- Deve permettere di scegliere la modalità di somministrazione, al sito effetto o plasmatico – più adatta al paziente, alla procedura chirurgica o alla pratica clinica.
- La modalità Simulazione deve consentire di valutare in anticipo l'effetto della somministrazione TCI.
- Interfaccia grafica, con codice colore in base alla modalità di somministrazione per permettere un avvio più semplice, rapido ed un controllo più preciso.
- La modalità TCI deve memorizzare i dati relativi ai farmaci anestetici, ai modelli farmacocinetici, alla diluizione e al modello di siringa.
- Deve permettere il controllo delle interazioni tra analgesico e ipnotico, con la visualizzazione simultanea degli di ogni farmaco.
- Devono potersi adattare i livelli ipnotici e analgesici ai tempi della procedura chirurgica.
- Deve permettere di visualizzare il tempo di "fine effetto" per ogni farmaco, il cambiamento del profilo di flusso associato ad una modifica della concentrazione target.
- Deve visualizzare con linea tratteggiata l'evoluzione della concentrazione nei successivi 15 minuti.
- Deve visualizzare dose e volume infusi dall'inizio dell'induzione.

Il sistema deve essere composto da:

N. 1 Base PRIMEA

N. 2 Pompe a siringa mod. DPS+ per l'infusione di farmaci endovenosi

Tale prodotto è commercializzato in esclusiva in Calabria dalla ditta ARGMA Medicali Srl di Caraffa di Catanzaro

